




РЕШЕНИЕ № 342314 от 11.10.2019

Об осуществлении закупок способом из одного источника

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Совместное предприятие Сернокислотный завод Казатомпром"

Осуществить следующие закупки способом из одного источника:


Номер строки ПЗ	Наименование закупаемых товаров, работ и услуг	Краткая характеристика (описание) товаров, работ и услуг	Дополнительная характеристика	Количество	Цена за единицу	Сумма закупки	Наименование поставщика	Место поставки	Основание для одного источника
1(1408 Т 1153375)	Термометр биметаллический	класс точности 0 1	Биметаллический термометр, исполнение из нержавеющей стали. Производитель WIKA. Длина погружной части 160мм. Модель TM55.01. Циферблат диаметра 100 мм. Материал корпуса нержавеющая сталь. Материал штока нержавеющая сталь. Присоединение к техпроцессу снизу (радиальное) подвижный штуцер внешняя резьба M20x1,5. Диаметр термобаллона 8 мм. Класс точности 1. Гидрозаполнение. Флюид - вода. Внесен в реестр единства измерении Республики Казахстан. Для доукомплектования бойлерной установки Энергоучастка.	2.000	85 105	170 210	Товарищество с ограниченной ответственностью "Kaz Electro Services Group"	Акмолинская область,г.Степногорск, промышленная зона 6, комплекс №5	137-1 (закупки одним из способов, предусмотренных пунктами 1) - 3), 5) пункта 15 Правил, признаны несостоявшимися)
2(1407 Т 1153374)	Термометр биметаллический	класс точности 0 1	Биметаллический термометр, исполнение из нержавеющей стали. Производитель WIKA. Модель TM55.01. Длина погружной части 80 мм. Циферблат диаметра 100 мм. Корпус из нержавеющей стали. Материал штока нержавеющая сталь. Присоединение к техпроцессу неподвижный штуцер внешняя резьба G 1/2B. Диаметр термобаллона 8 мм. Расположение	2.000	78 140	156 280	Товарищество с ограниченной ответственностью "Kaz Electro Services Group"	Акмолинская область,г.Степногорск, промышленная зона 6, комплекс №5	137-1 (закупки одним из способов, предусмотренных пунктами 1) - 3), 5) пункта 15 Правил, признаны несостоявшимися)

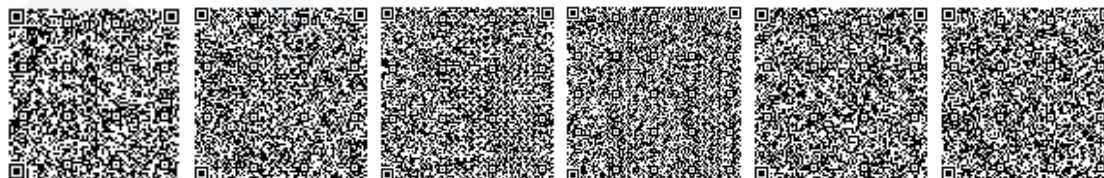




342314

			циферблата - радиальное. Класс точности 1. Плоское инструментальное стекло. Гидрозаполнение. Флюид - масло с температурой + 60 градусов по Цельсию. Внесен в реестр единства измерений Республики Казахстан. Для доукомплектования Турбогенератора.						
3(1415 Т 1153373)	Термометр	ТС	Манометрический термометр с капилляром, исполнение из нержавеющей стали. Производитель WIKA. Модель F73.160. Длина погружной части 3400 мм. Циферблат диаметра 160 мм. Диапазон шкалы от 0 до +200 градусов по Цельсию. Присоединение к техпроцессу неподвижный штуцер внутренняя резьба G 1/2В. Диаметр термобаллона 8 мм. Расположение циферблата - радиальное. Класс точности 1. Стекло многослойное безопасное. Флюид - расплавленная сера температурой + 180 градусов по Цельсию. Внесен в реестр единства измерений Республики Казахстан. Для доукомплектования местных контрольно-измерительных приборов	1.000	297 818	297 818	Товарищество с ограниченной ответственностью "Kaz Electro Services Group"	Акмолинская область,г.Степногорск, промышленная зона 6, комплекс №5	137-1 (закупки одним из способов, предусмотренных подпунктами 1) - 3), 5) пункта 15 Правил, признаны несостоявшимися)
4(1416 Т 1153372)	Термометр	ТС	Термометр сопротивления тип ТС-044, 100П с кабельным выводом до 15 метров. Подключение 3-х проводное. Рабочий диапазон измерения от минус 50 до плюс 250 градусов по Цельсии. Материал защитного корпуса нержавеющая сталь. Диаметр термобаллона 8 мм. Длина термобаллона 35 мм. Присоединение резьба M12x1,5. Расположение термобаллона - для монтажа в электродвигатель.	4.000	36 618	146 472	Товарищество с ограниченной ответственностью "Kaz Electro Services Group"	Акмолинская область,г.Степногорск, промышленная зона 6, комплекс №5	137-1 (закупки одним из способов, предусмотренных подпунктами 1) - 3), 5) пункта 15 Правил, признаны несостоявшимися)

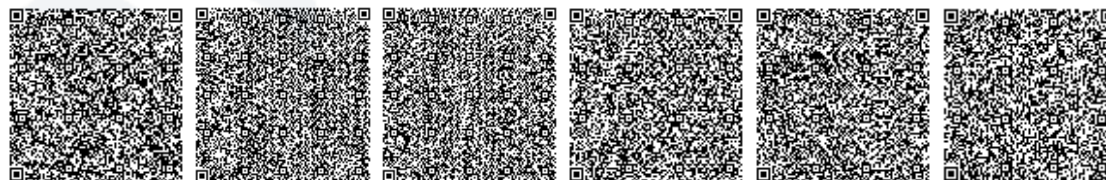




			Степень защиты IP65. Внесен в реестр единства измерений Республики Казахстан. Для доукомплектования электродвигателя градирни Энергоучастка.						
5(1406 T 1153371)	Преобразователь измерительный	напряжение переменного тока	Производитель Электроприбор. Тип E854ЭЛ. Выход унифицированного сигнала 4-20мА/ вход 0-5А. Питание прибора переменное напряжение 220 вольт частотой 50 Гц. Крепление под Дин-рейку. Для доукомплектования воздухоудвки 528К1А. Внесен в реестр единства измерений Республики Казахстан. Контроль пусковых и рабочих токов.	1.000	36 419	36 419	Товарищество с ограниченной ответственностью "Kaz Electro Services Group"	Акмолинская область,г.Степногорск, промышленная зона 6, комплекс №5	137-1 (закупки одним из способов, предусмотренных подпунктами 1) - 3), 5) пункта 15 Правил, признаны несостоявшимися)
6(1418 T 1153370)	Батарея	литиево-ионная, аккумуляторная	БУФЕРНАЯ БАТАРЕЯ фирмы Siemens для SIMATIC S7-400, 3.6В/2.3А/ЧАС, ДЛЯ PS 405 4А/10А/20А И PS 407 4А/10А/20А. Для доукомплектования ПЛК 90САВ.01	4.000	5 853	23 412	Товарищество с ограниченной ответственностью "Kaz Electro Services Group"	Акмолинская область,г.Степногорск, промышленная зона 6, комплекс №5	137-1 (закупки одним из способов, предусмотренных подпунктами 1) - 3), 5) пункта 15 Правил, признаны несостоявшимися)
7(1412 T 1153369)	Манометр	виброустойчивый	Манометр WIKA. Модель 233.30. Диапазон шкалы от 0 до 10 бар. Радиальное подключение. Класс точности 1. Для контроля давления на участке химочистки воды. Циферблат диаметра 63 мм. Материал чувствительного элемента 316SS. Степень защиты IP65. Стекло многослойное безопасное. Соединение к процессу резьба G1/4"В. Корпус нержавеющая сталь, с прочной защитной перегородкой и выдвунная задняя стенка. Температура измеряемый среды + 50 градусов по Цельсию. Температура окружающей среды от минус 20 до плюс 60 градусов	3.000	30 802	92 406	Товарищество с ограниченной ответственностью "Kaz Electro Services Group"	Акмолинская область,г.Степногорск, промышленная зона 6, комплекс №5	137-1 (закупки одним из способов, предусмотренных подпунктами 1) - 3), 5) пункта 15 Правил, признаны несостоявшимися)

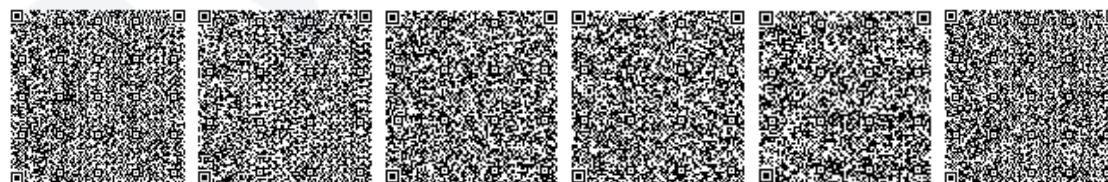




			по Цельсию. Серийный номер на циферблате "1555867", "1555868" и "1555869". Штифт ограничительный на нуле. Внесен в реестр единства измерений Республики Казахстан. Кольцо на корпусе байонетное кольцо, нержавеющей сталь. Заполненный глицерином 99,7%. Доукомплектования участка химочистка воды.						
8(1413 T 1153368)	Манометр	виброустойчивый	Манометр WIKA. Модель 233.30. Диапазон шкалы от 0 до 16 бар. Радиальное подключение. Класс точности 1,6. Для контроля давления дизельного топлива. Циферблат диаметра 63 мм. Соединение к процессу резьба G1/4"В. Стекло многослойное безопасное. Материал чувствительного элемента 316SS. Корпус нержавеющей сталь, с прочной защитной перегородкой и выдвунная задняя стенка. Кольцо на корпусе байонетное кольцо, нержавеющей сталь. Не заполненный жидкостью. Температура измеряемый среды + 100 градусов по Цельсию. Температура окружающей среды от минус 40 до плюс 60 градусов по Цельсию. Серийный номер на циферблате "1555866". Штифт ограничительный на нуле. Внесен в реестр единства измерений Республики Казахстан. Доукомплектования горелки пускового котла.	1.000	23 587	23 587	Товарищество с ограниченной ответственностью "Kaz Electro Services Group"	Акмолинская область,г.Степногорск, промышленная зона 6, комплекс №5	137-1 (закупки одним из способов, предусмотренных подпунктами 1) - 3), 5) пункта 15 Правил, признаны несостоявшимися)
9(1410 T 1153367)	Манометр	виброустойчивый	Манометр WIKA. Модель 233.30. Диапазон шкалы от 0 до 250 бар. Радиальное подключение. Класс точности 1,6. Для контроля давления гидравлики масла.	2.000	30 802	61 604	Товарищество с ограниченной ответственностью "Kaz Electro Services Group"	Акмолинская область,г.Степногорск, промышленная зона 6, комплекс №5	137-1 (закупки одним из способов, предусмотренных подпунктами 1) - 3), 5) пункта 15 Правил,

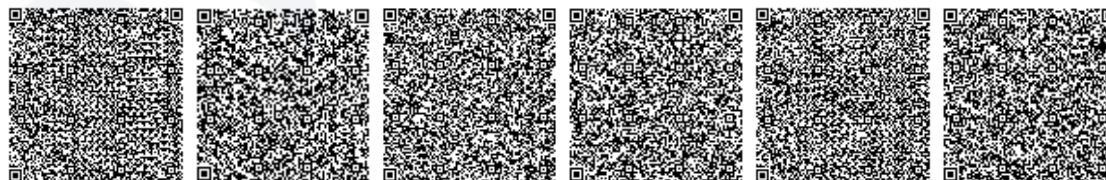



342314

			<p>Циферблат диаметра 63 мм. Материал чувствительного элемента 316SS. Степень защиты IP65. Соединение к процессу резьба G1/4"В. Стекло многослойное безопасное. Корпус нержавеющей сталь, с прочной защитной перегородкой и выдувная задняя стенка. Температура измеряемый среды + 100 градусов по Цельсию. Температура окружающей среды от минус 20 до плюс 60 градусов по Цельсию. Серийный номер на циферблате "1555366" и "1555367". Штифт ограничительный на нуле. Внесен в реестр единства измерении Республики Казахстан. Кольцо на корпусе байонетное кольцо, нержавеющей сталь. Заполненный глицерином 99,7%. Доукомплектования фильтра жидкой серы.</p>						признаны несостоявшимися)
10(1409 T 1153366)	Манометр	виброустойчивый	<p>Манометр WIKA. Модель 233.30. Диапазон шкалы от 0 до 16 бар. Осевое (сзади) эксцентричное подключение. Без гидрозаполнения. Класс точности 1,6. Для контроля давления осушки воздуха поз.1U1. Циферблат диаметра 63 мм. Соединение к процессу резьба 1/4"NPT. Материал чувствительного элемента 316SS. Степень защиты IP65. Корпус нержавеющей сталь, с прочной защитной перегородкой и выдувная задняя стенка. Кольцо на корпусе байонетное кольцо, нержавеющей сталь. Стекло многослойное безопасное. Температура измеряемый среды + 100 градусов по Цельсию. Температура окружающей среды</p>	2.000	30 802	61 604	Товарищество с ограниченной ответственностью "Kaz Electro Services Group"	Ақмолинская область,г.Степногорск, промышленная зона 6, комплекс №5	137-1 (закупки одним из способов, предусмотренных подпунктами 1) - 3), 5) пункта 15 Правил, признаны несостоявшимися)

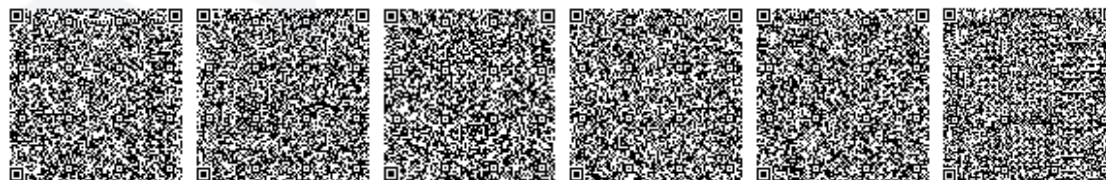



			от минус 20 до плюс 60 градусов по Цельсию. Серийный номер на циферблате "1555355" и "1555356". Штифт ограничительный на нуле. Внесен в реестр единства измерений Республики Казахстан. Для доукомплектования осушки воздуха.						
11(1419 T 1153365)	Клапан	невозвратно-запорный, стальной, размер 3-32 мм	Игольчатый трехходовой клапан для подключения манометров из нержавеющей стали. Исполнение: внутренняя / внутренняя резьба. Резьба присоединения М20×1,5. Максимальное рабочее давление 40 МПа. Максимальная рабочая температура 240 °С. Тип иглы плавающая.	10.000	18 125	181 250	Товарищество с ограниченной ответственностью "Kaz Electro Services Group"	Акмолинская область,г.Степногорск, промышленная зона 6, комплекс №5	137-1 (закупки одним из способов, предусмотренных подпунктами 1) - 3), 5) пункта 15 Правил, признаны несостоявшимися)
12(1414 T 1153364)	Манометр	виброустойчивый	Манометр WIKA. Модель 233.30. Диапазон шкалы от 0 до 25 бар. Радиальное подключение. Класс точности 1. Для контроля давления на участке химочистки воды. Циферблат диаметра 63 мм. Материал чувствительного элемента 316SS. Степень защиты IP65. Стекло многослойное безопасное. Соединение к процессу резьба G1/4"В. Корпус нержавеющей сталь, с прочной защитной перегородкой и выдвунная задняя стенка. Температура измеряемый среды + 50 градусов по Цельсию. Температура окружающей среды от минус 20 до плюс 60 градусов по Цельсию. Серийный номер на циферблате "1555967", "1555968" и "1555969". Штифт ограничительный на нуле. Внесен в реестр единства измерений Республики Казахстан. Кольцо на корпусе байонетное кольцо, нержавеющей сталь. Заполненный	4.000	30 802	123 208	Товарищество с ограниченной ответственностью "Kaz Electro Services Group"	Акмолинская область,г.Степногорск, промышленная зона 6, комплекс №5	137-1 (закупки одним из способов, предусмотренных подпунктами 1) - 3), 5) пункта 15 Правил, признаны несостоявшимися)





			глицерином 99,7%. Доукомплектования участка химочистка воды.						
13(1411 T 1153363)	Манометр	виброустойчивый	Манометр WIKA. Модель 233.30. Диапазон шкалы от 0 до 40 бар. Радиальное подключение. Класс точности 1,6. Для контроля давления дизельного топлива. Циферблат диаметра 63 мм. Соединение к процессу резьба G1/4"В. Стекло многослойное безопасное. Материал чувствительного элемента 316SS. Корпус нержавеющая сталь, с прочной защитной перегородкой и выдвунная задняя стенка. Кольцо на корпусе байонетное кольцо, нержавеющая сталь. Заполненный жидкостью. Температура измеряемой среды + 100 градусов по Цельсию. Температура окружающей среды от минус 20 до плюс 60 градусов по Цельсию. Устойчив к нагрузкам и ударам. Серийный номер на циферблате "1555766", "1555767" и "1555768". Штифт ограничительный на нуле. Внесен в реестр единства измерения Республики Казахстан. Доукомплектования горелки пускового котла.	3.000	23 587	70 761	Товарищество с ограниченной ответственностью "Kaz Electro Services Group"	Акмолинская область, г. Степногорск, промышленная зона 6, комплекс №5	137-1 (закупки одним из способов, предусмотренных подпунктами 1) - 3), 5) пункта 15 Правил, признаны несостоявшимися)

Договор о закупках способом из одного источника заключается в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты принятия решения об осуществлении закупок способом из одного источника

Утверждено:

Директор Жексембаев Толеужан Сагимбекович 11.10.2019 13:45

Согласовано:

